

河南省消化内镜诊疗质控数据定期规范化 填报操作手册

一、系统操作流程



咨询、维护电话：13333869581

二、账号注册及说明

以下 2 种途径认证的账号，可填写本医疗机构消化内镜诊疗质控数据月报：

（一）已经通过国家消化内镜中心官网，完成 2020 年消化内镜普查填报系统注册认证的账号，可直接登录系统填报。

（二）新注册账号，注册流程如下：

1. 登录 HNCIS 省消化内镜诊疗质量控制中心子网站

(<http://hncis.hnwsjk.cn/xiaohua/>)，点击“质控指标填报”模块。

河南省消化内镜诊疗质量控制中心
Henan Province Quality Control Center of Digestive endoscopy

请输入要搜索的关键词

网站首页 政策法规 质控指标 质控体系 技术规范 通知公告 质控动态 下载中心 **质控指标填报**

中心简介
河南省消化内镜质控中心是在河南省卫健委领导下负责全省各级医疗机构消化内镜业务指导和质量管理的组织。成立于2013年，挂靠河南省人民医院。
河南省消化内镜质控中心的日常工作接受省卫健委医政处指导，其主要任务是：
1、按省卫健委的要求，负责制订消化内镜专业的质量管理标准和操作规范，经专业委员会讨论，报卫生行政部门审定后实施；
[查看详细](#)

成员介绍

	杨玉秀 消化内镜诊疗质控中心 顾问
	李修岭 消化内镜诊疗质控中心 主任委员
	冯百岁 消化内镜诊疗质控中心 副主任委员

[更多](#)

通知公告

15 关于召开河南省医疗服务与质量安全报告（2022年）编制培训会的...
2023-11

- 河南省全面提升医疗质量行动实施方案（2023-2025年） 11-14
- 河南省医疗质量控制中心管理办法 11-12
- 关于召开2023年三门峡市消化内镜质量控制中心工作会议的通知 07-19
- 关于印发河南省消化内镜专业 2023 年质控工作 改进目标 “提高... 07-13
- 河南省卫生健康委关于成立河南省 消化内镜诊疗质量控制专家... 06-20

质控动态

- 2023年安阳市消化内镜质控会 08-09
- 2023年三门峡市消化内镜质控中心会议 08-09

质控体系

- 河南省消化内镜诊疗质量控制专业委员会名单 07-19
- 各地市已成立消化内镜诊疗质量控制中心单位 07-13

河南省消化内镜质量信息填报系统

欢迎使用质控填报系统

[账号登录](#) | [验证码登录](#)

请输入账号

请输入密码

还没有账号？ **立即注册**

2. 进入网站，点击登录页面“立即注册”按钮。

质控月报填报系统

用户注册

1 用户信息 2 医院信息

姓名:

手机号:

验证码: |

已有账号? [立即登录](#)

3. 填写填报人姓名及手机号、验证码后点击下一步。

质控月报填报系统

用户注册

✓ 用户信息 2 医院信息

地区:

医院:

科室:

4. 选择相应的地区、医院、科室信息后提交审核，审核结果会以短信形式通知，审核通过后可登录系统填报。若审核未

通过，请根据短信提示信息重新注册。

若医院列表或科室列表中无可选医院和科室，请联系管理员：13333869581（微信同号）。


三、网页版填报方法

（一）质控指标数据填报

1. 登录 HNCIS 省消化内镜诊疗质量控制中心子网站（<http://hncis.hnwsjk.cn/xiaohua/>），点击“质控指标填报”模块。



2. 进入“质控指标填报”系统登录页面。填写账号、密码登录。

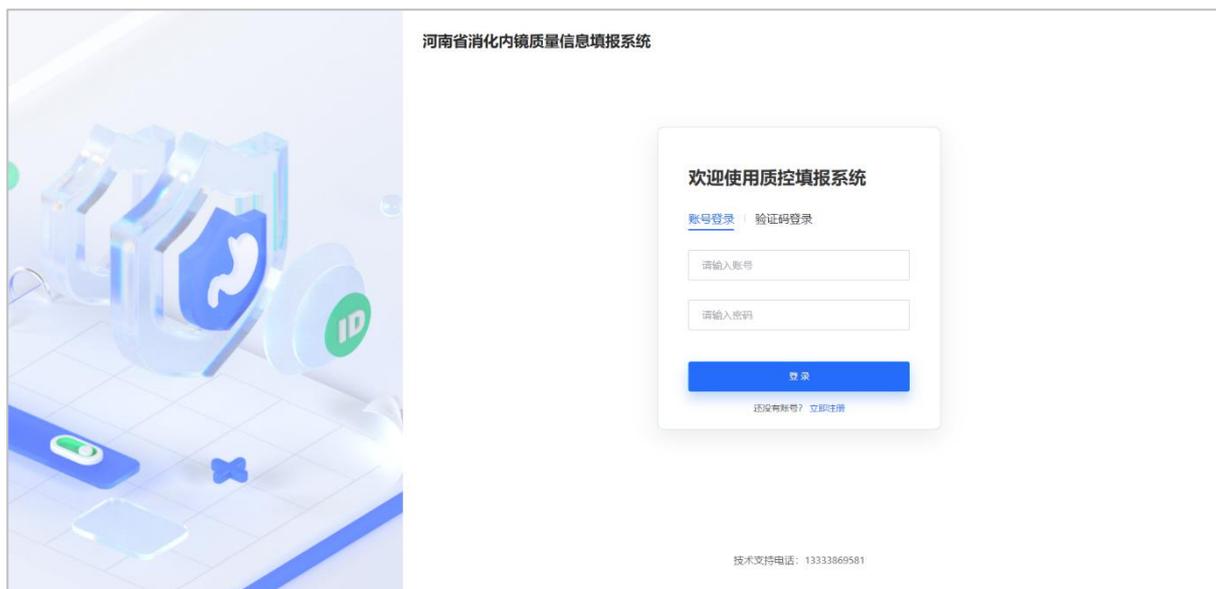

备注：建议使用 Chrome、Edge 98 版本以上的浏览器，推荐操作屏幕分辨率 1920*1080。



2. 点击相应月份，逐月填写。每个指标，需填写其分子、分母，系统将自动计算该指标的百分率。每月数据填报核对正确后，点击右上角“立即提交”按钮完成填写。填写完成并提交后，该月状态更新为“已完成”，未全部填写完成的月报状态为“填报中”，可继续填写后提交。

河南省XXX医院 质控报表

2023年 2月 质控报表

2023年 下拉框

1月 进行中

2月 已完成

3月 已完成

4月 已完成

5月 待填报

6月 待填报

7月 待填报

8月 待填报

9月 待填报

10月 待填报

11月 待填报

2023年2月消化内镜质控指标数据月报

质控指标

序号	质控指标	数据	结果
01	消化内镜中心医师平均工作量	计算分子: 1259 计算分母: 38	34.18 例/人
02	四级消化内镜诊疗技术占比	计算分子: 17 计算分母: 1297	1.31 %
03	三级消化内镜诊疗技术占比	计算分子: 93 计算分母: 1297	7.17 %

张医生

3. 数据修改。完成提交后，页面信息不可编辑，如需编辑点击右上角的“撤销提交”按钮，如上图所示。完成修改后，再点击“立即提交”，完成本月份质控指标数据的提交。

(二) 内镜室信息填报



点击页面右上侧“内镜室信息填报”按钮，进入填写页面，完成信息填写后，点击“立即提交”按钮，完成提交。

质控报表 / 内镜室信息填报

医疗机构及消化内镜中心基本情况

立即提交

机构基本信息

1. 医院
美迪康互联网医院

2. 机构性质
 医疗机构 健康体检中心

3. 机构所有制形式
 公立 民营

4. 医院是否是：中医医院、中医（综合）医院、中西医结合医院
 是 否

机构基本信息
消化内镜中心基本信息
消化内镜中心人员信息
内镜中心仪器设备信息

(三) 洗消信息填报



点击页面右上侧“洗消信息填报”按钮，进入填写页面，

完成信息填写后，点击“立即提交”按钮，完成提交。



The screenshot shows a web form titled "消化内镜的清洗、消毒与灭菌" (Cleaning, Disinfection, and Sterilization of Gastrointestinal Endoscopy). The form includes the following sections:

- 1. 内镜中心是否设立独立的清洗消毒室** (Whether the endoscopy center has a dedicated cleaning and disinfection room):
 - Radio buttons for "有" (Yes) and "无" (No).
 - A text input field for "面积" (Area) with the value "331" and the unit "平方米" (square meters).
- 2. 消毒室是否有紫外线消毒装置** (Whether the disinfection room has a UV disinfection device):
 - Radio buttons for "有" (Yes) and "无" (No).
- 3. 消化内镜中心主要清洗消毒设备(多选)** (Main cleaning and disinfection equipment in the endoscopy center, multiple choice):
 - Checkboxes for "三槽式" (Three-compartment), "百槽(五槽)式" (Hundred-compartment/Five-compartment), "内镜手工清洗消毒工作站(五池式)" (Endoscopy manual cleaning and disinfection workstation (five-pool)), and "全自动内镜清洗消毒机" (Automatic endoscopy cleaning and disinfection machine).

四、手机版填报方法

在网页版进行注册登录后，可通过手机 APP 填报数据。扫描下方二维码或手机应用商城下载“AnyMed 医生版”。



在手机安装 APP，安装完成后运行“AnyMed 医生版”。



(一) 质控指标数据填报

1. 登录系统后，进入“医疗”—“消化内镜质控中心”模块。



2. 点击“质控月报”，进入月报填写列表页面。




3. 填报方法同网页版。填报分为质控指标和内镜诊疗情况，可通过标签页或“下页”按钮切换，每月指标核对正确后，点击页底“立即提交”按钮完成填写。填写完成并提交后，该月状态更新为“完成”，未全部填写完成的月报状态为“填报中”，可点击操作栏“继续填报”按钮，继续填写。



Category	Total (including examination and treatment)
03 超声内镜	26
超声内镜引导下的介入诊疗术	2
胰腺假性囊肿/脓肿内镜介入治疗术	2
04 ERCP	3
05 小肠镜	0

4. 数据修改。完成提交后，页面信息不可编辑，如需编辑点击内镜诊疗页面底部的“撤销提交”按钮。完成修改后，再点击“立即提交”，完成本月份质控数据的提交。

(二) 内镜室及洗消信息填报

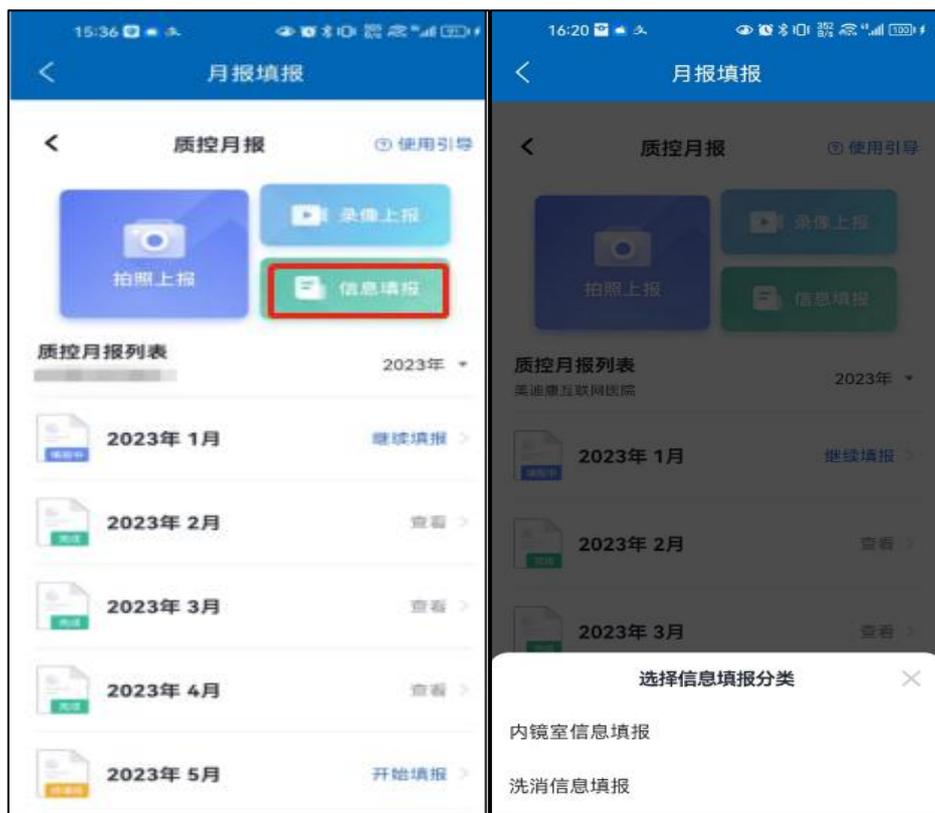

点击“月报填报”的首页面，包含“内镜室信息填报”和“洗消信息填报”两部分，点击要填写的部分，完成填写后，点击“提交”按钮，完成填报。

五、数据权限管理

后期会开放各市级质控中心查看所属地区医疗机构所有消化内镜质控数据权限，便于质控管理。请已成立的市级质控中心负责人及秘书联系管理员，电话：13333869581。